


Измерители влажности и температуры одно-, двух-, и четырех-канальные

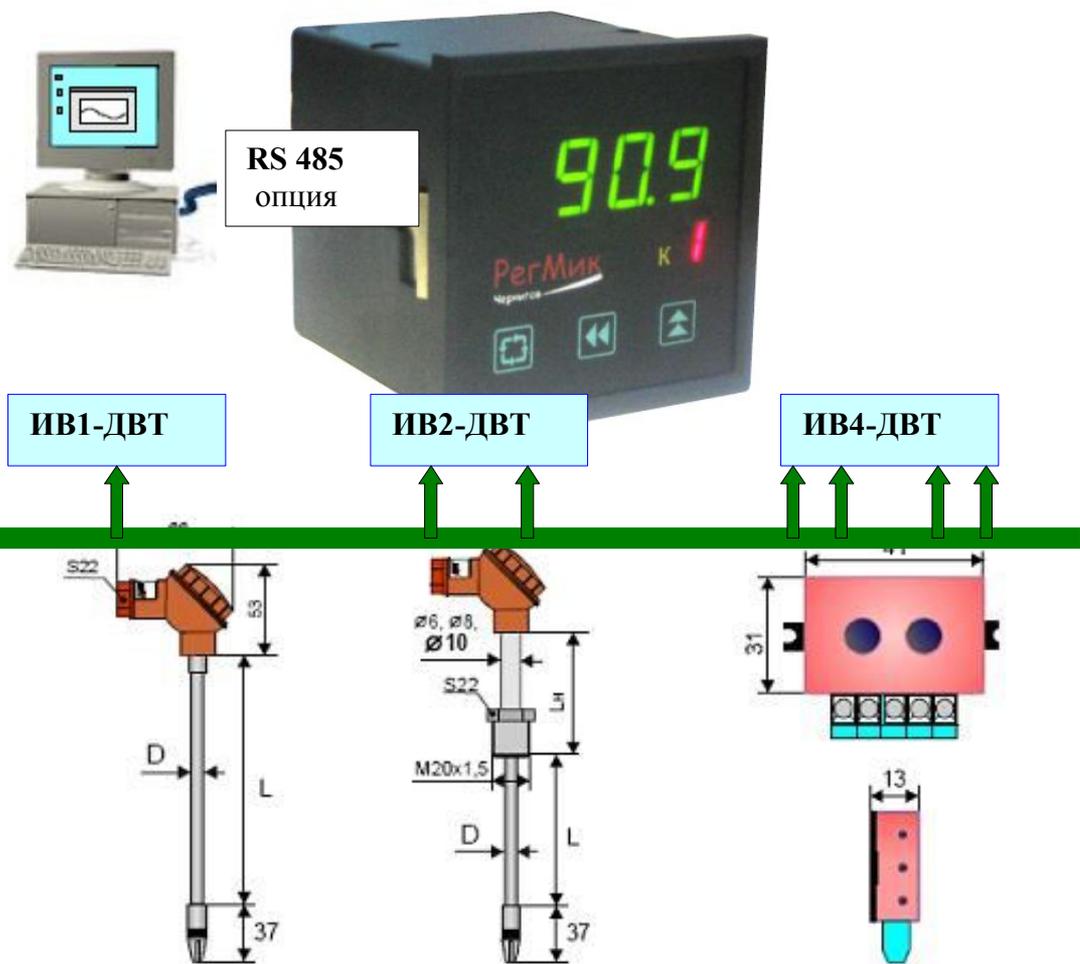

ДВТ-001ц
Rh = 0..100% , +/- 3%
t = -35+120C , +/-1.5%

ДВТ-002ц
Rh = 0..100% , +/- 3%
t = -35+120C +/-1.5%

ДВТ-302ц
Rh = 0..100%
t = -30+85C

